DENTSPLY MAILLEFER

propex·pixi™

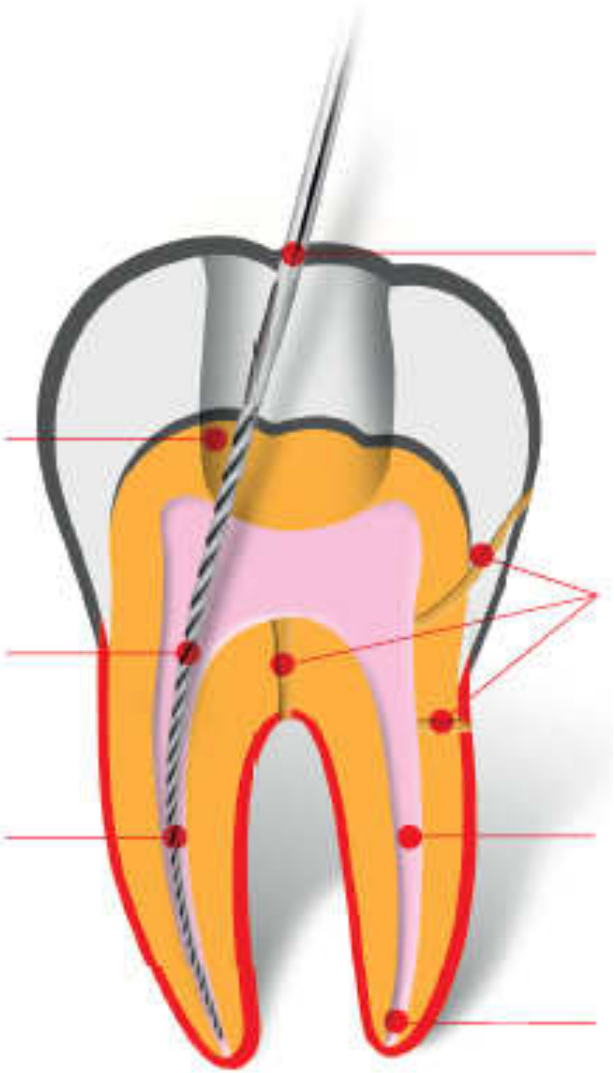

Usar goma dique durante el tratamiento de conducto

Evitar que la lima o el clip labial contacte con estructuras dentales metálicas

Secar la cavidad de acceso

Las fracturas radiculares, perforaciones, las caries profundas y los conductos laterales amplios, pueden dar resultados inexactos

Usar una lima que se adapte al diámetro del foramen

Humedecer con Glyde™ los conductos excesivamente secos, para obtener una lectura fiable

El localizador de ápices no funcionará en un conducto obliterado

Los dientes con un foramen de diámetro grande, pueden dar lecturas falsas

Para ver las contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso consultar el Manual del Usuario del propex pixi™

Características
De funcionamiento

1 — La lima entra en el conducto
Pitido doble

2 — Las limas en la zona pre-apical:
‹‹2.0›› a ‹‹1.5››
Pitido intermitente

3 — Zona apical: ‹‹1.0›› a ‹‹0.0››
Pitido continuo

4 — FUERA (OVER): La lima ha pasado a través del foramen apical
Pitidos intermitentes rápidos

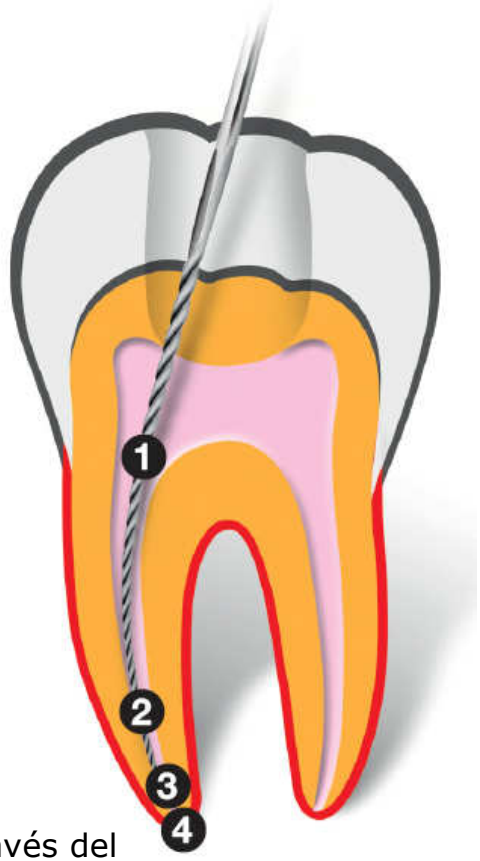

OBSERVACIÓN

• Se recomienda hacer una radiografía antes de usar el localizador de ápices y comparar la información. En caso de discrepancia clínica relevante, hacer una segunda radiografía con una lima a la longitud de trabajo

• Para evitar la sobre-instrumentación, se recomienda colocar la lima en una regla endodóntica, con el tope de goma colocado en el punto donde el propex•pixi™ indica ‹‹APEX›› y luego restar un mínimo de 0,5mm a la longitud obtenida.

• La escala ‹‹2.0›› a ‹‹0.0›› no representa la distancia en mm. – indica la progresión de la lima hacia el ápice